



Desfibrilador Automático Implantable (DAI)

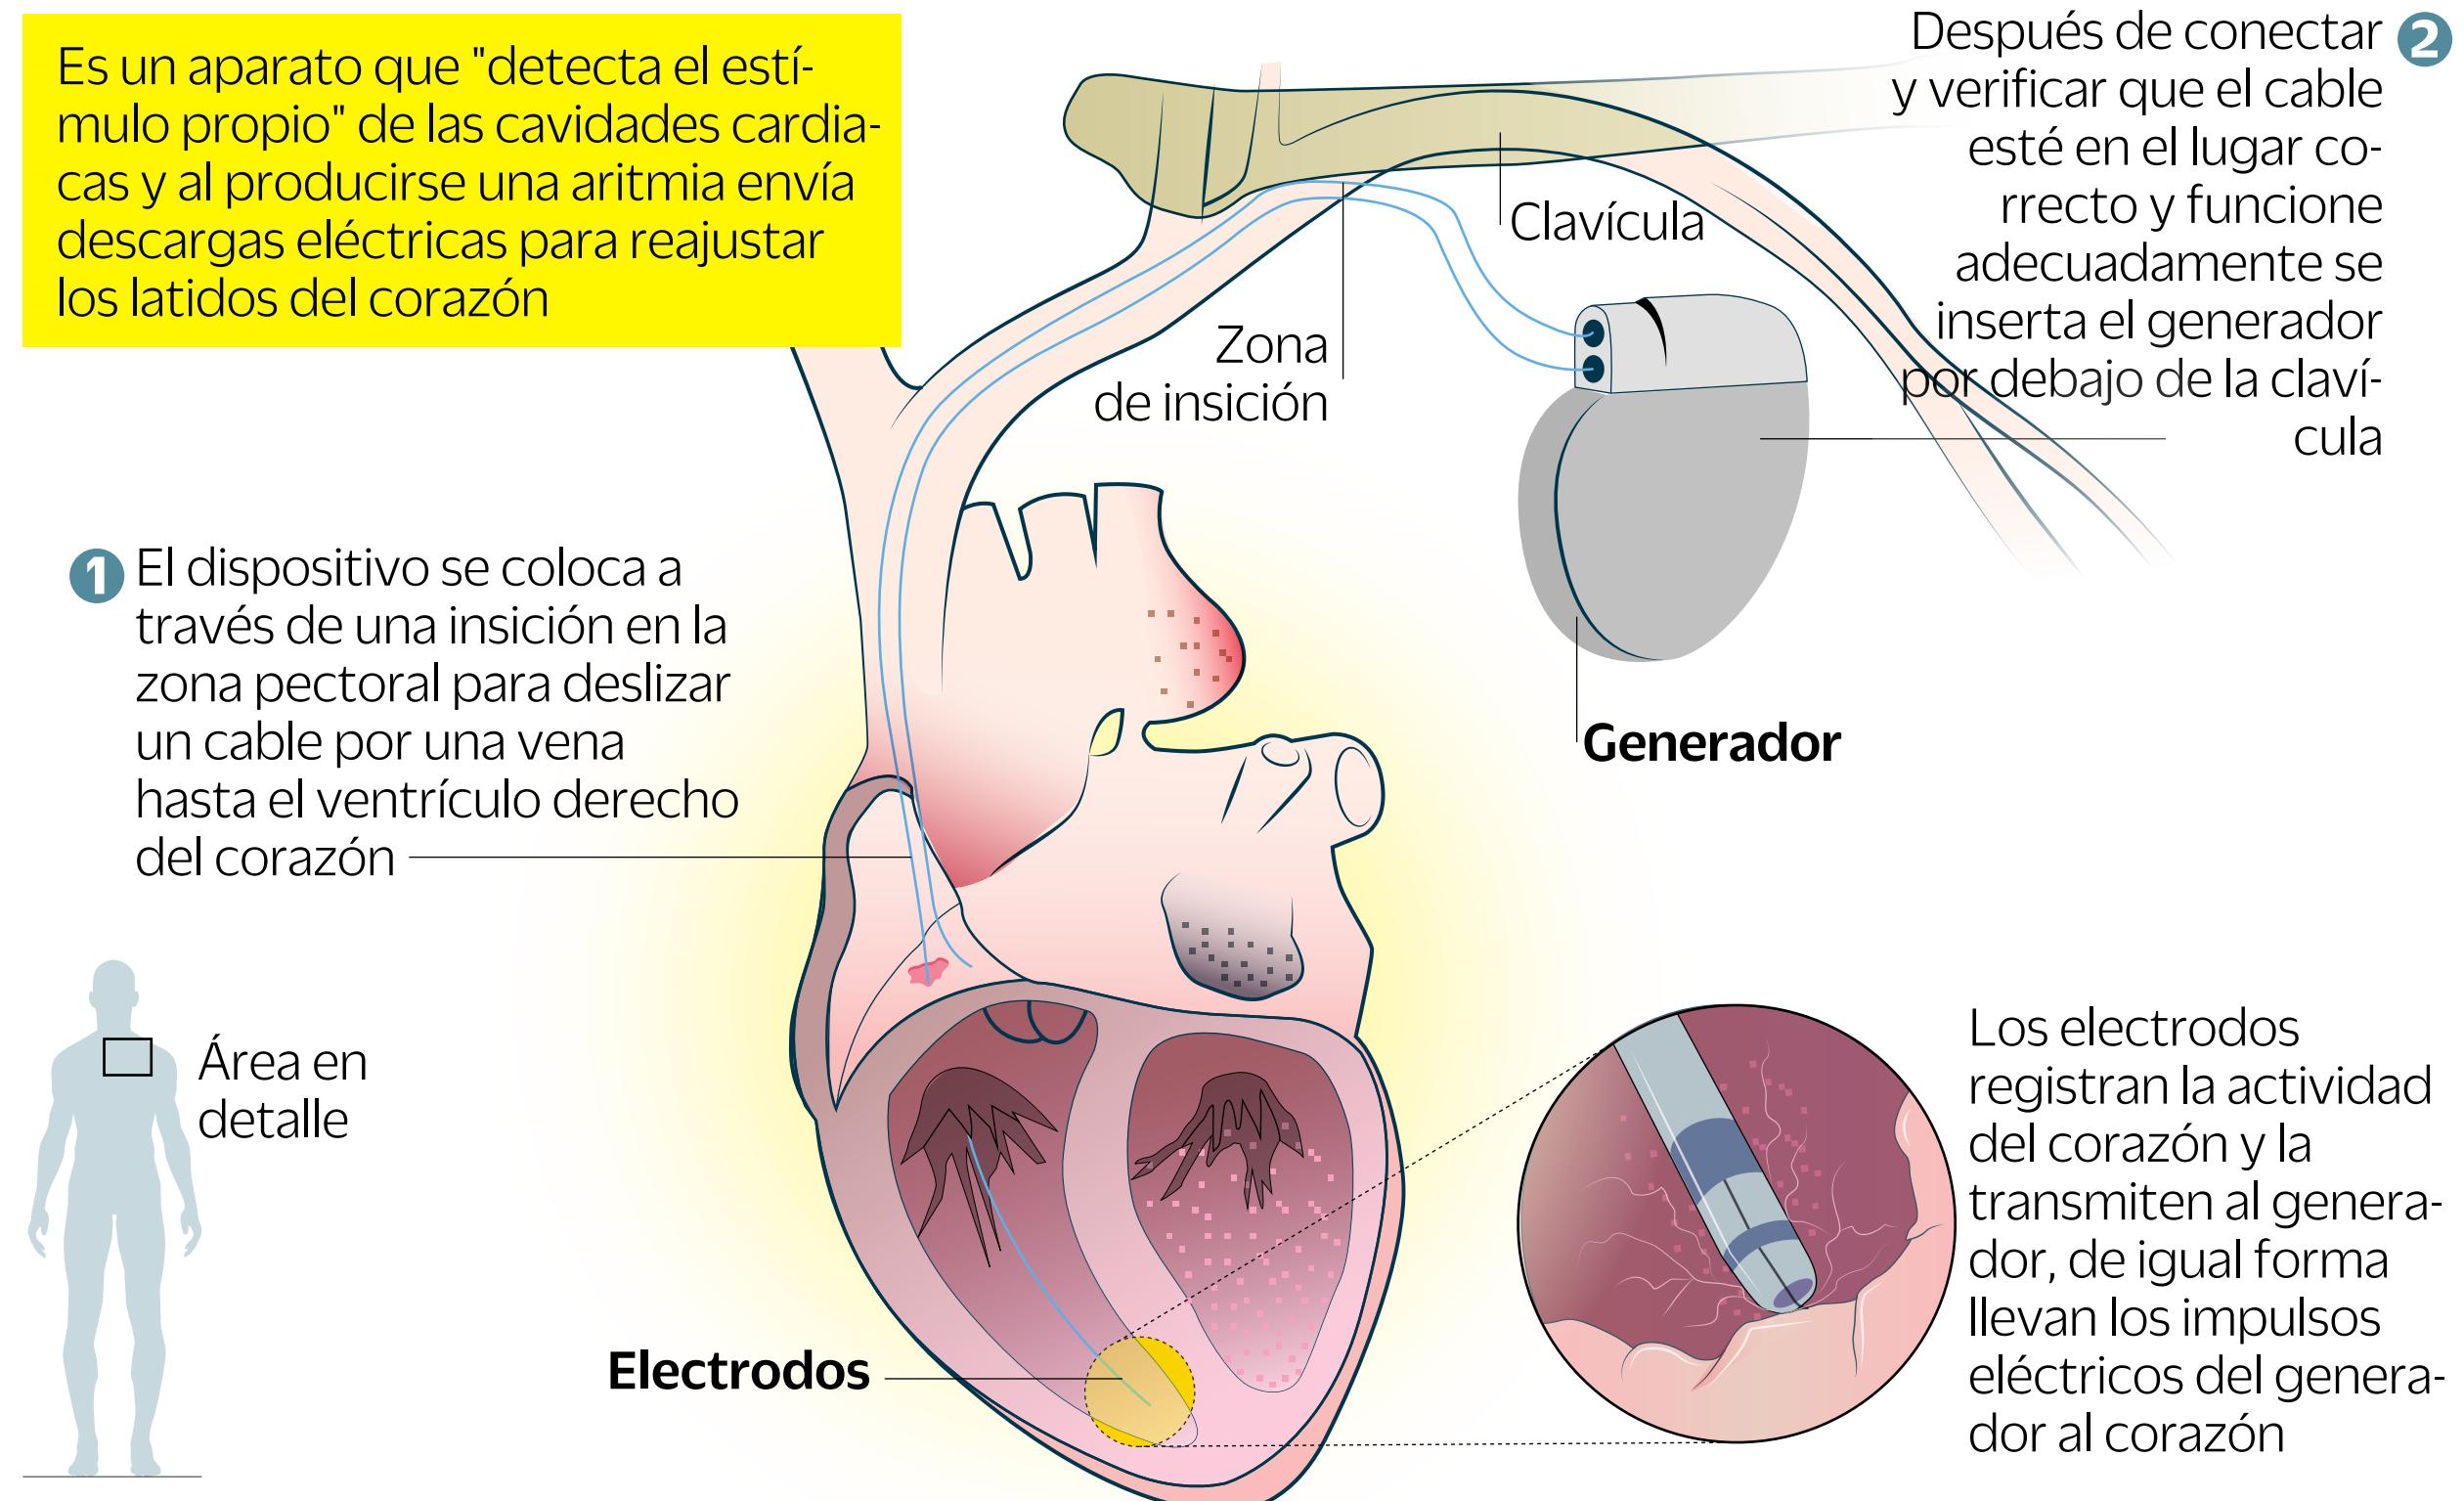


Modos de implantación

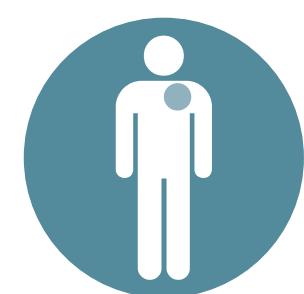

Endovenoso o endocárdico

Se introducen por la vena subclavia hasta el ventrículo del corazón, el generador queda alojado debajo del pectoral (subcutáneo)



Modo epicárdico

Esta forma de implante se deja exclusivamente para pacientes con problemas vasculares. El generador en estos casos queda alojado en el abdomen (subcutáneo)


Cuidados y recomendaciones



Evitar estar cerca de los aparatos que generan, transmiten o usan electricidad cuyos campos electromagnéticos alteran el funcionamiento del aparato




Mantenerse alejado de teléfonos inalámbricos o aparatos eléctricos como aspiradoras, cuchillos o imanes, celulares y ordenadores



Distanciarse de transformadores, alambradas eléctricas, cargadores de batería, motores o máquinas de soldadura



No utilizar electroestimuladores (para reducción de grasa corporal), colchones y almohadas magnéticas



Alejarse de arcos magnéticos (aeropuerto y otras zonas de control)